

### **Bekanntmachung**

einer Markterhebung zur Interessensbekundung an der Teilnahme an einer Ausschreibung unter EU-Schwelle für die Einrichtung eines Labors zu hygrothermischen Charakterisierung von Baumaterialien, HyLAB – unterteilt in 5 (fünf) Lose -

Eurac Research beabsichtigt, gemäß den geltenden Rechtsvorschriften, ein Vergabeverfahren zwecks Erbringung der im Betreff genannten Lieferung vorzunehmen. Deshalb wird die gegenständliche Markterhebung durchgeführt, zwecks Identifizierung von Wirtschaftsteilnehmern, die Interesse an einer potentiellen Teilnahme am gegenständlichen Verfahren haben.

#### **Beschreibung der Lieferung und technische Spezifikationen:**

##### **Los 1 (eins): Laborwaagen**

###### **1.1 Analysenwaage**

- Stückzahl: 1
- Maximalgewicht: 220 g
- Präzision: 0.01 mg bis 60 g, 0.02 mg bis 120 g, 0.05 mg bis 220 g
- Wiederholbarkeit: bis zu 0.04 mg bei 200 g
- Mindestgröße des Wäge-Moduls: 80 x 80 mm
- Staub- und Wasserschutz
- Schnittstellen: RS232 und Ethernet
- Inkl. automatischer Nivellierung mit motorisiertem System
- Inkl. automatischer Kalibrierung und Regelung
- Inkl. integriertem Ionisator zur Beseitigung elektrostatischer Aufladungen

### **Avviso**

di indagine di mercato per manifestazione di interesse a partecipare ad una procedura di gara sotto soglia comunitaria per l'allestimento di un laboratorio per la caratterizzazione igrotermica di materiali edili, HyLAB – Suddivisa in 5 (cinque) Lotti -

Eurac Research intende attivare, ai sensi della normativa vigente, una procedura di gara per la fornitura in oggetto. Pertanto effettua la seguente indagine di mercato ai fini dell'individuazione di operatori economici interessati ad una potenziale partecipazione alla procedura in oggetto.

#### **Descrizione della fornitura e relative specifiche tecniche:**

##### **Lotto 1 (uno): bilance da laboratorio**

###### **1.1 Bilancia analitica**

- Numero: 1
- Portata massima: 220 g
- Risoluzione: 0.01 mg fino a 60 g, 0.02 mg fino a 120 g, 0.05 mg fino a 220 g
- Ripetibilità: minore di 0.04 mg a 200 g
- Dimensione minima piatto di pesatura: 80 x 80 mm
- Tipo di protezione: contro polvere e acqua
- Interfaccia: RS232 e Ethernet
- Comprensiva di funzione di livellamento automatica per mezzo di sistema motorizzato
- Dotata di funzione di calibrazione e regolazione automatica
- Comprensiva di ionizzatore integrato per l'eliminazione delle cariche elettrostatiche

- Inkl. SD-Karte
- Inkl. Modul zur Datenkommunikation zu Computer oder gleichwertigem
- Inkl. Vorrichtung zur Dichtebestimmung
- Inkl. Installation und Konfiguration der Waage
- Windschutz aus Glas
- Garantie: 24 Monate

### 1.2 Präzisionswaage

- Stückzahl: 1
- Maximalgewicht: 1200 g
- Präzision: 1 mg
- Wiederholbarkeit: bis zu 0.8 mg bei 500 g
- Mindestgröße des Wäge-Moduls: 120 x 120 mm
- Staub- und Wasserschutz
- Schnittstellen: RS232 und Ethernet
- Inkl. automatischer Nivellierung mit motorisiertem System
- Inkl. automatischer Kalibrierung und Regelung
- Inkl. SD-Karte
- Inkl. Modul zur Datenkommunikation zu Computer oder gleichwertigem
- Inkl. Installation und Konfiguration der Waage
- Windschutz aus Glas
- Garantie: 24 Monate

### 1.3 Präzisionswaage

- Stückzahl: 1
- Maximalgewicht: 6200 g
- Präzision: 10 mg
- Wiederholbarkeit: bis zu 8 mg bei 500 g
- Mindestgröße des Wäge-Moduls: 200 x 200 mm
- Staub- und Wasserschutz
- Schnittstellen: RS232 und Ethernet
- Inkl. automatischer Nivellierung mit motorisiertem System
- Inkl. automatischer Kalibrierung und Regelung
- Inkl. SD-Karte
- Inkl. Modul zur Datenkommunikation zu Computer oder gleichwertigem

- Comprensiva di scheda SD
- Comprensiva di modulo di comunicazione dati verso computer o equivalente
- Comprensiva di kit per la misurazione della densità
- Servizio di installazione e configurazione della bilancia incluso
- Protezione anticorrente in vetro
- Garanzia: 24 mesi

### 1.2 Bilancia di precisione

- Numero: 1
- Portata massima: 1200 g
- Risoluzione: 1 mg
- Ripetibilità: minore di 0.8 mg a 500 g
- Dimensione minima piatto di pesatura: 120 x 120 mm
- Tipo di protezione: contro polvere e acqua
- Interfaccia: RS232 e Ethernet
- Comprensiva di funzione di livellamento automatica per mezzo di sistema motorizzato
- Dotata di funzione di calibrazione e regolazione automatica
- Comprensiva di scheda SD
- Comprensiva di modulo di comunicazione dati verso computer o equivalente
- Servizio di installazione e configurazione della bilancia incluso
- Protezione anticorrente in vetro
- Garanzia: 24 mesi

### 1.3 Bilancia di precisione

- Numero: 1
- Portata massima: 6200 g
- Risoluzione: 10 mg
- Ripetibilità: minore di 8 mg a 500 g
- Dimensione minima piatto di pesatura: 200 x 200 mm
- Tipo di protezione: contro polvere e acqua
- Interfaccia: RS232 e Ethernet
- Comprensiva di funzione di livellamento automatica per mezzo di sistema motorizzato
- Dotata di funzione di calibrazione e regolazione automatica
- Comprensiva di scheda SD
- Comprensiva di modulo di comunicazione dati verso computer o equivalente

- Inkl. Installation und Konfiguration der Waage

- Garantie: 24 Monate


#### 1.4 Präzisionswaage mit Aufhängung

- Stückzahl: 3
- Inkl. Aufhängung nach unten, zur Bestimmung der Wasseraufnahme von Festkörpern (siehe Bild unten)
- Maximalgewicht: 6200 g
- Präzision: 10 mg bis 1500 g, 20 mg bis 3000 g, 50 mg bis 6200 g
- Wiederholbarkeit: unter 8 mg bei 500 g, unter 40 mg bei 6000 g
- Staub- und Wasserschutz
- Schnittstellen: RS232 und Ethernet
- Inkl. automatischer Nivellierung mit motorisiertem System
- Inkl. automatischer Kalibrierung und Regelung
- Inkl. SD-Karte
- Inkl. Modul zur Datenkommunikation zu Computer oder gleichwertigem  
Inkl. Installation und Konfiguration der Waage
- Garantie: 24 Monate

- Servizio di installazione e configurazione della bilancia incluso
- Garanzia: 24 mesi

#### 1.4 Bilancia di precisione con pesatura sottostante sospesa

- Numero: 3
- Comprensiva di sistema per pesare dei campioni sospesi dal di sotto della bilancia (vedi immagine sottostante)
- Portata massima: 6200 g
- Risoluzione: 10 mg fino a 1500 g, 20 mg fino a 3000 g e 50 mg fino a 6200 g
- Ripetibilità: minore di 8 mg a 500 g, minore di 40 mg a 6000 g
- Tipo di protezione: contro polvere e acqua
- Interfaccia: RS232 e Ethernet
- Comprensiva di funzione di livellamento automatica per mezzo di sistema motorizzato
- Dotata di funzione di calibrazione e regolazione automatica
- Comprensiva di scheda SD
- Comprensiva di modulo di comunicazione dati verso computer o equivalente
- Servizio di installazione e configurazione della bilancia incluso
- Garanzia: 24 mesi

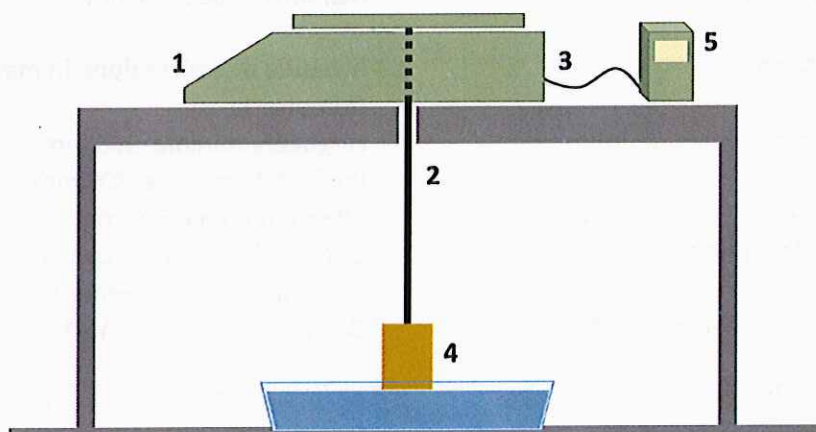

**Legende Abbildung:**

1. Waage
2. Arm, der den Festkörper/Probe zur Messung der Wasseraufnahme hält
3. Schnittstelle RS232/Ethernet
4. Festkörper/Probe
5. Datalogger oder Computer

**Los 2 (zwei): Laborgefäße in Kunststoff und Glas**

**2.1 Exsikkatoren aus transparentem Polykarbonat**

- Stückzahl: 20
- Außendurchmesser:  $280 \pm 10$  mm
- Innendurchmesser:  $250 \pm 10$  mm
- Kompatibel mit Standardplatten für Exsikkatoren von 230 mm
- Höhe:  $330 \pm 20$  mm
- Nutzbare Höhe:  $200 \pm 20$  mm
- Inkl. Deckel und luftdichtem Verschluss
- Inkl. Ventilanschluss abnehmbar

**2.2 Gelochte Exsikkatorplatte aus Polypropylen**

- Stückzahl: 30
- Durchmesser:  $230 \pm 10$  mm
- Kompatibel mit Exsikkator aus Abschnitt 2.1

**2.3 Gelochte Exsikkatorplatte aus Porzellan**

- Stückzahl: 1
- Durchmesser:  $280 \pm 10$  mm

**2.4 Trockenschrank in Acryl**

- Stückzahl: 1
- Mindestbreite: 305 mm
- Mindestdiefe: 305 mm
- Mindesthöhe: 305 mm
- Tür mit luftdichtem Abschluss
- Inkl. mind. 3 herausnehmbaren Regalböden

**2.5 Zylinderförmige Behälter in Glas ohne Deckel**

- Stückzahl: 30
- Mindestfassungsvermögen: 500 ml
- Außendurchmesser: von 115 mm bis 140 mm
- Höhe: von 65 mm bis 75 mm
- Ohne Ausguss

**Legenda figura:**

1. Bilancia
2. Braccio che sostiene il campione da pesare
3. Interfaccia RS232/Ethernet
4. Campione
5. Data-logger o computer

**Lotto 2 (due): recipienti da laboratorio in plastica e vetro**

**2.1 Essiccatori in policarbonato trasparente**

- Numero: 20
- Diametro esterno:  $280 \pm 10$  mm
- Diametro interno:  $250 \pm 10$  mm
- Compatibile con piastre per essiccatore standard da 230 mm
- Altezza:  $330 \pm 20$  mm
- Altezza utile:  $200 \pm 20$  mm
- Comprensivo di coperchio e chiusura ermetica
- Comprensivo di rubinetto rimovibile

**2.2 Piastra di essiccazione perforata in polipropilene**

- Numero: 30
- Diametro:  $230 \pm 10$  mm
- Compatibile con essiccatori al punto 2.1

**2.3 Piastra di essiccazione perforata in porcellana**

- Numero: 1
- Diametro:  $280 \pm 10$  mm

**2.4 Armadio di essiccazione in materiale acrilico**

- Numero: 1
- Larghezza minima: 305 mm
- Profondità minima: 305 mm
- Altezza minima: 305 mm
- Dotato di sportello con guarnizioni che garantiscano una chiusura ermetica
- Comprensivo di almeno 3 scaffali rimovibili

**2.5 Recipienti cilindrici in vetro senza coperchio**

- Numero: 30
- Capacità minima: 500 ml
- Diametro esterno: da 115 mm a 140 mm
- Altezza: da 65 mm a 75 mm
- Senza beccuccio

**Los 3 (drei): Laborgeräte zur Messung thermischer Eigenschaften von Baustoffen**

**3.1 Gerät zur Messung der thermischen Eigenschaften von Baustoffen**

- Stückzahl: 1
- Gerät zur Messung der Wärmeleitfähigkeit und Wärmekapazität von Baustoffen
- Ausstattung zur Messung der thermischen Eigenschaften von Dämmstoffen mit Zell-, Kunststoff-, Glas- und Mineralstruktur
- Messprinzip auf Basis der Temperaturantwort auf Wärmestromimpulse
- Inkl. Oberflächen- und Einstichsonde
- Messbereich Wärmeleitfähigkeit mit Oberflächen-sonde: von 0.04 bis 6 W/mK
- Messbereich Wärmeleitfähigkeit mit Einstichsonde: von 0.015 bis 2 W/mK
- Messbereich Wärmekapazität: von  $4 \times 10^4$  J/m<sup>3</sup>K bis  $3 \times 10^6$  J/m<sup>3</sup>K
- Präzision der Wärmeleitfähigkeit:  $\leq 0.001$  W/mK + 5% des Messwerts bei  $\lambda < 0.7$  W/mK;  $\leq 10\%$  des Messwerts bei  $\lambda > 0.7$  W/mK
- Präzision der Wärmekapazität:  $\leq 1 \times 10^3$  J/m<sup>3</sup>K + 15% des Messwerts
- Wiederholbarkeit der Messung der Wärmeleitfähigkeit:  $\leq 0.001$  W/mK + 3 % des Messwerts
- Wiederholbarkeit der Messung der Wärmekapazität:  $\leq 1 \times 10^3$  J/m<sup>3</sup>K + 3 % des Messwerts
- Messergebnis speicherbar auf internem Speicher, Anzeige auf Display und über Verbindung zu einem PC über USB oder RS232 Schnittstelle
- Interner Datenspeicher:  $\geq 1$  GB
- Stromversorgung: Netzstecker und Akku
- Inkl. Transportkoffer
- Garantie: 18 Monate

**Los 4 (vier): Laborgeräte zur Messung der pf-Kurve von Baustoffen**

**4.1 Gerät zur Messung des pF-Kurve von Baustoffen**

**Lotto 3 (tre): Strumentazione per la misurazione di proprietà termiche di materiali edili**

**3.1 Analizzatore di proprietà termiche di materiali edili**

- Numero: 1
- Strumento per la misura della conducibilità termica e della capacità termica volumica di materiali edili
- In grado di misurare le proprietà termiche di materiali isolanti a struttura cellulare, plastici, vetrosi e minerali
- Principio di misura basato sull'analisi della risposta di temperatura a flussi di calore impulsivi
- Comprensivo di sonda di superficie e di sonda ad ago
- Campo di misura della conducibilità termica con sonda di superficie: da 0.04 a 6 W/mK
- Campo di misura della conducibilità termica con sonda ad ago: da 0.015 a 2 W/mK
- Campo di misura della capacità termica volumica: da  $4 \times 10^4$  J/m<sup>3</sup>K a  $3 \times 10^6$  J/m<sup>3</sup>K
- Accuratezza per la misura di conducibilità termica:  $\leq 0.001$  W/mK + 5% di lettura per  $\lambda < 0.7$  W/mK;  $\leq 10\%$  di lettura per  $\lambda > 0.7$  W/mK
- Accuratezza per la misura della capacità termica volumica:  $\leq 1 \times 10^3$  J/m<sup>3</sup>K + 15% di lettura
- Riproducibilità per la misura di conducibilità termica:  $\leq 0.001$  W/mK + 3 % di lettura
- Riproducibilità per la misura della capacità termica volumica:  $\leq 1 \times 10^3$  J/m<sup>3</sup>K + 3 % di lettura
- Risultato delle misurazioni memorizzabile su una memoria interna, visibile su display e tramite connessione su un PC tramite porta USB o RS232
- Memoria interna:  $\geq 1$  GB
- Alimentazione elettrica: tramite connettore elettrico e a batteria
- Comprensivo di valigetta per il trasporto
- Garanzia: 18 mesi

**Lotto 4 (quattro): Strumentazione per la misura della curva di ritenzione igrica di materiali edili**

- Drucktopf 5 bar inkl. Deckel u. Verschlüsse, 2 Stück
- Drucktopf 15 bar inkl. Deckel u. Verschluss und oleopneumatisches Scharnier zum Anheben des Deckels, 2 Stück
- Druckluftleitungen, Verbinder und Druckregler für 4 Drucktöpfe (2 zu 5 bar und 2 zu 15 bar)
- Kompressor für den Betrieb der 4 Drucktöpfe (2 zu 5 bar und 2 zu 15 bar), inkl. Armaturen und Druckluftleitungen, Distanz Kompressor – Drucktöpfe: 10 m
- Keramikplatte 0.5 bar, kompatibel mit den Drucktöpfen zu 5 bar und zu 15 bar, 8 Stück
- Keramikplatte 1 bar, kompatibel mit den Drucktöpfen zu 5 bar und zu 15 bar, 4 Stück
- Keramikplatte 3 bar, kompatibel mit den Drucktöpfen zu 5 bar und zu 15 bar, 4 Stück
- Keramikplatte 5 bar, kompatibel mit den Drucktöpfen zu 5 bar und zu 15 bar, 4 Stück
- Keramikplatte 15 bar, kompatibel mit den Drucktöpfen zu 5 bar und zu 15 bar, 6 Stück
- Durchflussmesser zur Überprüfung der einwandfreien Funktion der Keramikplatten, 1 Stück
- Inkl. Installation der Ausrüstung
- Garantie: 12 Monate

#### **Los 5 (fünf): Laborgeräte zur Erzeugung eines Vakuums**


Für die Beschreibung der Artikel, die in diesem Los gekauft werden sollen, weisen wir auf die nachfolgende Abbildung hin. Um die Anordnung der einzelnen Komponenten wie im Schema dargestellt zu realisieren, muss insbesondere die Kompatibilität der einzelnen Bauteile untereinander und an den Anschlussstellen gewährleistet werden.

#### **4.1 Strumentazione per la misura della curva di ritenzione igrica di materiali edili**

- Estrattore da 5 bar comprensivo di coperchio e di chiusure, 2 pezzi
- Estrattore da 15 bar comprensivo di coperchio, di chiusure e di cerniera oleopneumatica per sollevamento coperchio, 2 pezzi
- Sistema di regolazione della pressione per 4 estrattori (2 da 5 bar e 2 da 15 bar), manicotti di raccordo e regolatore di pressione
- Compressore per il funzionamento di 4 estrattori (2 da 5 bar e 2 da 15 bar) comprensivo di connettori e linea di aria compressa, distanza tra compressore e estrattori con sistema di regolazione della pressione: 10 m
- Piastra ceramica da 0.5 bar compatibile con gli estrattori da 5 bar e da 15 bar, 8 pezzi
- Piastra ceramica da 1 bar compatibile con gli estrattori da 5 bar e da 15 bar, 4 pezzi
- Piastra ceramica da 3 bar compatibile con gli estrattori da 5 bar e da 15 bar, 4 pezzi
- Piastra ceramica da 5 bar compatibile con gli estrattori da 5 bar e da 15 bar, 4 pezzi
- Piastra ceramica da 15 bar compatibile con gli estrattori da 5 bar e da 15 bar, 6 pezzi
- Flussometro per la verifica del corretto funzionamento dei piatti ceramici, 1 pezzo
- Servizio di installazione dell'apparecchiatura incluso
- Garanzia: 12 mesi

#### **Lotto 5 (cinque) Strumentazione da vuoto**

Per la descrizione degli elementi da acquistare in questo lotto facciamo riferimento alla figura sottostante. In particolare dovrà essere garantita la compatibilità dei vari elementi acquistati nei punti di raccordo con l'obiettivo di andare a costruire un sistema analogo a quello rappresentato in figura.

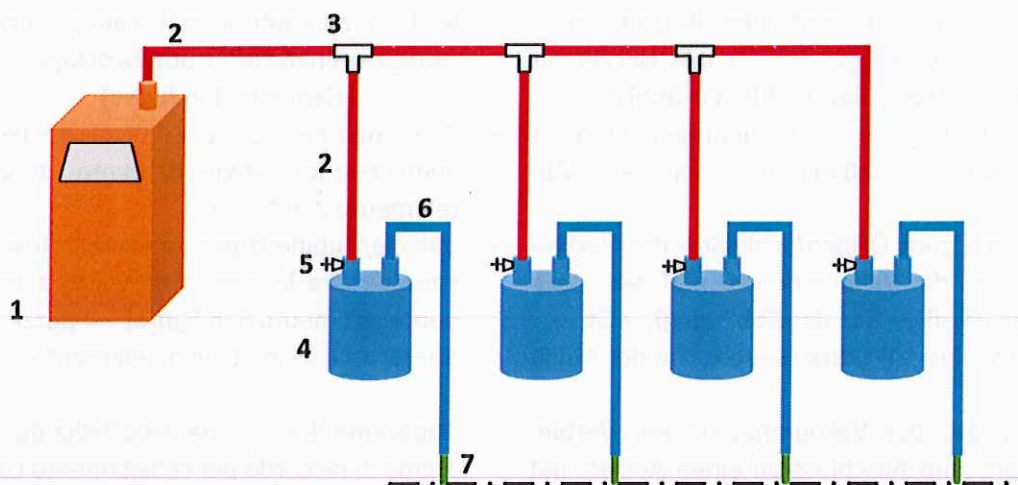

**Legende Abbildung:**

1. Vakuumpumpe mit Vakuumregelsystem (siehe 5.1)
2. Verbindungsleitung zwischen Vakuumpumpe und Vakuumflaschen (siehe 5.2)
3. Drei-Wege-Anschluss kompatibel mit Rohrleitung von Bauteil 2 (siehe 5.2)
4. Vakuumflasche (siehe 5.2)
5. Ventil/Hahn (siehe 5.2)
6. Auslassschlauch von der Vakuumflasche
7. Verbindungssystem zum Anschluss der Rohrleitung an Bauteil 6 mit einem Außendurchmesser von 3.3 mm (siehe 5.2)

**Legenda figura:**

1. Pompa da vuoto dotata di sistema di regolazione del vuoto (vedi 5.1)
2. Tubazione di raccordo tra pompa da vuoto e bottiglie da vuoto (vedi 5.2)
3. Raccordo a tre vie compatibile con tubazione al punto 2 (vedi 5.2)
4. Bottiglia da vuoto (vedi 5.2)
5. Valvola/Rubinetto (vedi 5.2)
6. Tubazione di uscita dalla bottiglia da vuoto
7. Sistema di raccordo per il collegamento della tubazione al punto 6 con un attacco con diametro esterno pari a 3.3 mm (vedi 5.2)

**5.1 Membran-Vakuumpumpe (Bauteil 1 in der Abbildung)**

- Inkl. Vakuumkontrollsystem, gesteuert durch einen elektronischen Mikroprozessor, der die Umdrehungen des Pumpenmotor regelt
- Anzahl Stufen: 3
- Maximales Saugvermögen: 1.7 m<sup>3</sup>/h
- Endvakuum: 5 mbar
- Endvakuum mit Gasballast: 7 mbar
- Geschwindigkeit zum Erreichen eines Vakuums von 5 mbar in einem 5 Liter Behälter: 140 Sek.
- Garantie: 24 Monate

**5.2 Anschlussystem Vakuumpumpe mit 4 Anschlüssen mit einem Außendurchmesser von 3.3 mm (siehe Abbildung oben)**

**5.1 Pompa da vuoto a membrana (elemento 1 in figura)**

- Fornita di sistema di controllo del vuoto gestito mediante un microprocessore elettronico che regola il numero di giri del motore della pompa
- Numero di stadi: 3
- Velocità di pompaggio massima: 1.7 m<sup>3</sup>/h
- Vuoto massimo effettivo: 5 mbar
- Vuoto massimo effettivo con gas ballast aperto: 7 mbar
- Velocità di raggiungimento del vuoto pari a 5 mbar in recipiente da 5 lt: 140 sec.
- Garanzia: 24 mesi

**5.2 Sistema per il collegamento della pompa da vuoto con 4 attacchi con diametro esterno pari a 3.3 mm (vedere figura soprastante)**

- Vakuumflasche aus Kunststoff oder Glas, mit einem Mindestfassungsvermögen von 1 l, inkl. Deckel mit 2 Eingängen - 4 Stück (Bauteil 4 in der Abbildung)
- Vakuumrohrleitung für Vakuumpumpenanschluss mit Vakuumflaschen - 10 m Länge (Position 2 in Abbildung)
- Ventile/Hähne zum Öffnen/Schließen der Verbindung zwischen der Vakuumpumpe und den Vakuumflaschen (Position 5 in der Abbildung) - 4 Stück
- 3-Wege-Anschluss - 6 Stück (Bauteil 3 in der Abbildung)
- Abflussrohr aus der Vakuumflasche mit Verbindungssystem zum Anschluss an einen Aufsatz mit einem Außendurchmesser von 3.3 mm - Länge 10 m (Bauteil 6 und 7 in der Abbildung)
- Bottiglia da vuoto in materiale plastico o vetro, di capacità minima di 1 l, dotata di tappo con 2 entrate - 4 pezzi (elemento 4 in figura)
- Tubazione da vuoto per il raccordo della pompa da vuoto con le bottiglie da vuoto - lunghezza 10 m (elemento 2 in figura)
- Valvole/Rubinetti per apertura/chiusura del collegamento tra la pompa da vuoto e le bottiglie da vuoto (elemento 5 in figura) - 4 pezzi
- Raccordo a 3 vie - 6 pezzi (elemento 3 in figura)
- Tubazione di uscita dalla bottiglia da vuoto con sistema di raccordo per collegamento con un attacco con un diametro esterno di 3.3 mm - lunghezza 10 m (elementi 6 e 7 in figura)

Im Falle einer ausdrücklichen Einladung zur Abgabe eines Angebotes von Seiten dieser Vergabestelle, kann das Angebot auch nur für ein Los eingereicht werden. Der Auftrag wird gemäß dem Kriterium des Preises vergeben.

#### Teilnahmevoraussetzungen

An der gegenständlichen Markterhebung sind die Wirtschaftsteilnehmer laut Artikel 45, Absatz 2, des Gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 50/2016 zugelassen und demzufolge eingeladen, die Interessensbekundungen zu übermitteln, sofern sie im Besitz folgender Voraussetzungen sind:

- keine Ausschlussgründe laut Artikel 80 des gesetzvertretenden Dekrets Nr. 50/2016;
- berufliche Voraussetzungen laut Artikel 83, Absatz 1, Buchstabe a) des gesetzvertretenden Dekrets Nr. 50/2016: Einschreibung in das Register der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer.

Die Übermittlung der Interessensbekundung gilt als Erklärung, im Besitz der vom Art. 80 des gesetzvertretenden Dekrets Nr. 50/2016 festgelegten allgemeinen Anforderungen zu sein.

In caso di invito espresso di questa stazione appaltante a presentare una offerta, si potrà presentare l'offerta anche per un solo lotto.

L'aggiudicazione avverrà per mezzo del criterio del solo prezzo.

#### Requisiti di partecipazione

Sono ammessi alla presente indagine di mercato e sono invitati ad inviare manifestazioni di interesse gli operatori economici di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti:

- mancanza di motivi di esclusione previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016;
- requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016: iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato, e agricoltura.

L'invio della manifestazione di interesse vale quale dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale come stabilito dal art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016.

Das Verfahren wird elektronisch durchgeführt über das Internetportal „Elektronische Vergaben“ [www.ausschreibungen-suedtirol.it](http://www.ausschreibungen-suedtirol.it) der Autonomen Provinz Bozen, d.h. der interessierte Bewerber muss im telematischen Verzeichnis der Wirtschaftsteilnehmer des genannten Portals eingetragen sein, ansonsten kann der interessierte Bewerber nicht zum Verhandlungsverfahren zur obgenannten Vergabe eingeladen werden. Die Einschreibung erfolgt unter folgendem Link: <https://ausschreibungen-suedtirol.it/> - Abschnitt: WIRTSCHAFTSTEILNEHMER- Unterabschnitt: Registrierung telematisches Verzeichnis der WT (Anleitungen im Unterabschnitt: Unterlagen und Anleitungen Handbuch - Telematisches Verzeichnis); Grüne Nummer für die Wirtschaftsteilnehmer bei Fragen zur Verwendung der Plattform für elektronische Vergaben: 800.885122

Außerdem muss der interessierte Bewerber, mit Sitz in Italien, im Besitz einer gültigen digitalen Unterschrift sein.

Bei Fehlen der digitalen Unterschrift müssen die **Wirtschaftsteilnehmer mit Sitz in EU-Ländern** über eine gültige fortgeschrittene elektronische Signatur verfügen, die auf einem gültigen qualifizierten Zertifikat beruht und die von einer sicheren Signaturerstellungseinheit erstellt wird (Richtlinie 1999/93/EG vom 13.12.1999).

Sollten Sie an einer Teilnahme an der obgenannten Ausschreibung interessiert sein, ersuchen wir Sie Ihre Interessensbekundung zwecks Erhalt eines Einladungsschreibens innerhalb vom 28.05.2018, an diese Vergabestelle zukommen zu lassen.

Die Interessensbekundung kann mittels PEC-Mail: [administration@pec.eurac.edu](mailto:administration@pec.eurac.edu) oder Fax: (0039) 0471055009 geschickt werden.

Eine nach diesem Termin eingereichte Interessensbekundung kann nicht berücksichtigt werden.

La gara sarà svolta in via telematica attraverso il portale internet “Gare telematiche” della Provincia Autonoma di Bolzano [www.bandi-altoadige.it](http://www.bandi-altoadige.it), che significa che i candidati interessati devono essere iscritti nell’Elenco telematico degli operatori economici del predetto portale, altrimenti il candidato interessato non può essere invitato alla procedura in oggetto. Di seguito il Link al quale è possibile effettuare l’iscrizione: <https://www.bandi-altoadige.it> – Sezione: OPERATORI ECONOMICI - Sottosezione: Registrazione elenco telematico degli operatori economici (istruzioni in Sottosezione: Documentazione e istruzioni →Manuale - Registrazione Elenco Telematico); numero verde dedicato agli operatori economici per avere informazioni in merito: 800 885 122.

I candidati interessati, con sede in Italia, devono essere, inoltre, in possesso di una firma digitale valida. In mancanza di una firma digitale **gli operatori economici con sede in UE** dovranno essere in possesso di firma elettronica avanzata in corso di validità basata su un certificato qualificato e creato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura (direttiva 1999/93/CE del 13 dicembre 1999).

In caso di interesse ad un potenziale invito a partecipare alla procedura di cui sopra si chiede di fare pervenire la propria manifestazione di interesse alla scrivente stazione appaltante entro il 28.05.2018, specificando il proprio interesse ad essere invitati alla gara.

La manifestazione di interesse potrà essere inviata tramite posta elettronica certificata al seguente recapito pec: [administration@pec.eurac.edu](mailto:administration@pec.eurac.edu) oppure tramite fax allo (0039) 0471055009.

La manifestazione di interesse pervenuta dopo il termine indicato non sarà presa in considerazione.

Der Interessensbekundung darf weder ein wirtschaftliches noch ein technisches Angebot beigelegt werden.

Das gegenständliche Schreiben ist eine reine vorherige Marktkonsultation, begründet keine Einladungspflicht, begründet für den Empfänger keine Ansprüche oder Befugnisse und ist für Eurac Research in keiner Weise verbindlich. Die Interessensbekundungen haben den einzigen Zweck Eurac Research das Interesse für den Erhalt einer Einladung zur Angebotsabgabe mitzuteilen. Mit gegenständlicher Mitteilung, ohne Verbindlichkeit für Eurac Research, wird überprüft, ob auf dem Markt Wirtschaftsteilnehmer vorhanden sind, die die im Betreff genannten Lieferungen durchführen können.

Die von den Antragstellern gelieferten Daten werden im Sinne des GVD 196/2003 sowie GDPR 679/2016 ausschließlich für die mit der Durchführung der im Betreff genannten Ausschreibung verbundenen Zwecke verwendet. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie in der Anlage „INTERESSENSBEKUNDUNG/ANTRAG UM EINLADUNG“.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Stephan Ortner  
Direktor

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica né tecnica.

Resta inteso che la presente comunicazione è una mera consultazione preliminare di mercato, non determina alcun obbligo d'invito alla gara, non fa sorgere in capo al destinatario alcun diritto e facoltà e tantomeno vincola Eurac Research in alcun modo. Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare ad Eurac Research la disponibilità ad essere invitati a presentare un'offerta. Con la presente comunicazione, quindi non impegnativa per Eurac Research, si intende pertanto verificare la presenza sul mercato di operatori in grado di fornire quanto in oggetto.

I dati forniti dai soggetti manifestanti il proprio interesse verranno trattati ai sensi dei D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 679/2016 esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative alla presente comunicazione. Per ulteriori informazioni relative al trattamento dei dati personali si rimanda all'Allegato "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE/RICHIESTA DI INVITO".

Distinti saluti

Dott. Stephan Ortner  
Direttore